


低温恒温恒湿器（型式：PL-3J）

温度と湿度を独立してコントロールすることにより、高温多湿・低温乾燥など様々な環境条件を槽内に創り出す装置。

最大到達低温度域は、 -40°C まで到達可能。

● 温湿度制御可能範囲図

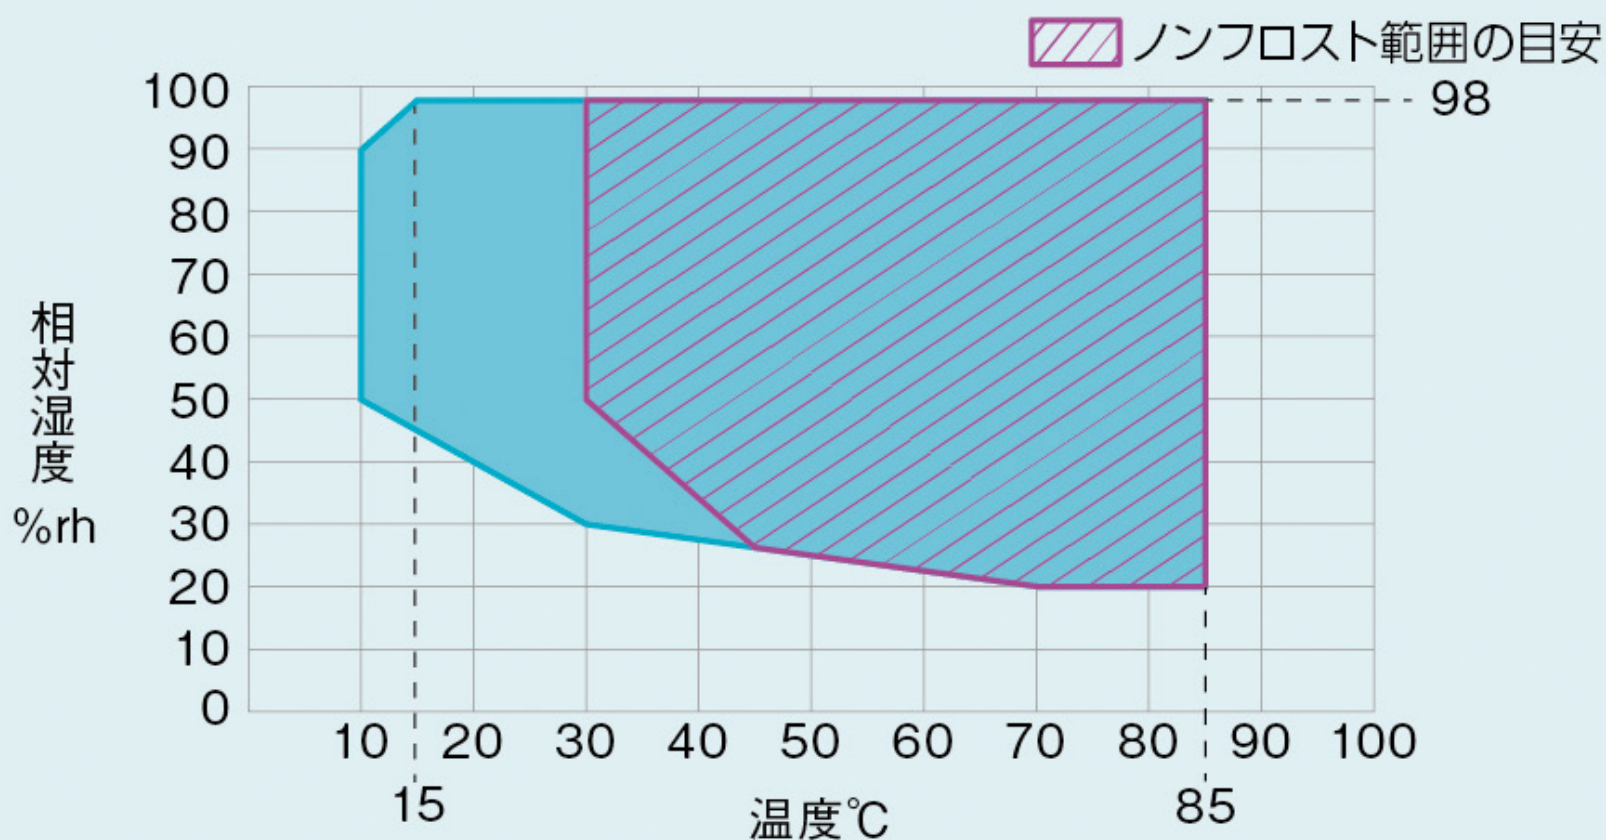

※外囲温度が $+23^{\circ}\text{C}$ における無試料の場合。

※ $+40^{\circ}\text{C}$ 以下の湿度運転において冷却器の着霜があるため、連続運転に制限があります。

温度範囲： $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$

湿度範囲：20%rh $\sim$ 98%rh

テストエリア寸法：W600×H850×D800mm

温度極値到達時間（上昇）： $+20^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ 30分

温度極値到達時間（下降）： $+20^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$ 約60分

<オプション仕様>

- ・槽内床面補強 200 kg